



MEDICOVER TÁJÉKOZTATÓ


MINTAVÉTEL SZÉKLET MIKROBIOM VIZSGÁLATHOZ

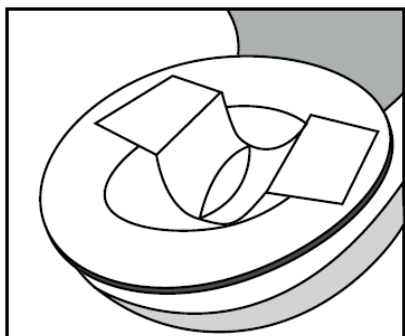


Helyezze a mellékelt „wc-papírt” az ábrán látható módon a wc ülőkére. Nyissa ki a mintavételi eszközt és a puffert tartalmazó csomagolást.

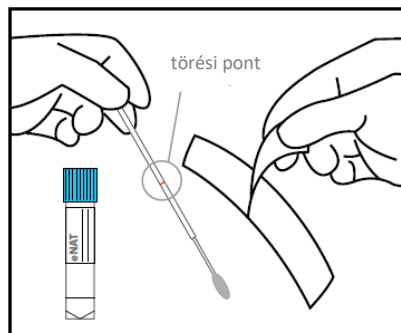


A mintavételi eszközön egy törési pont látható, piros vonallal jelezve.

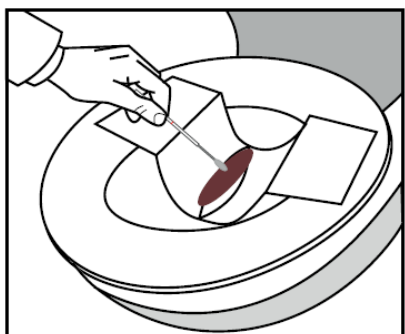

Helyezze a mintavevő eszközt a székletbe, és forgassa az eszközt körülbelül 5 másodpercig.

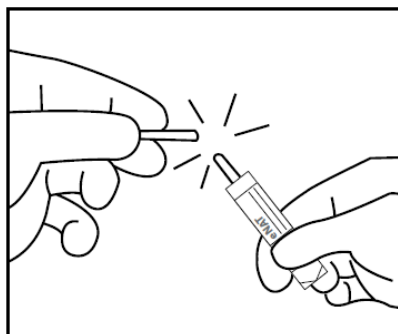


Nyissa ki a puffert tartalmazó csövet. Kerülje a folyadékkal történő érintkezést. Helyezze a pálcát a csőbe, és törje le a törési pontnál.

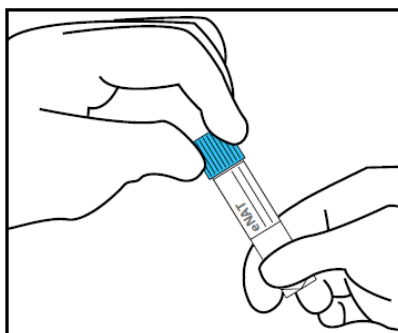


Szorosan zárja le a csövet, és óvatosan rázza körülbelül 10 másodpercig. A csőre írja rá a nevét és születési dátumát. Helyezze vissza a zacskóba és a zacskóra is írja rá a nevét. A mintát szobahőmérsékleten tárolja a leadásig.

MEDICOVER TÁJÉKOZTATÓ


MINTAVÉTEL SZÉKLET MIKROBIOM VIZSGÁLATHOZ

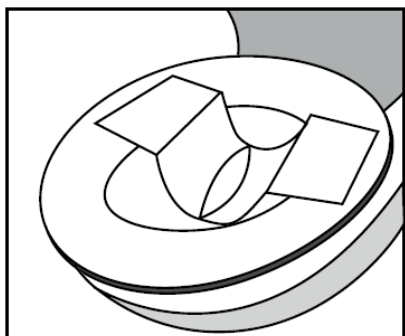


Helyezze a mellékelt „wc-papírt” az ábrán látható módon a wc ülőkére. Nyissa ki a mintavételi eszközt és a puffert tartalmazó csomagolást.

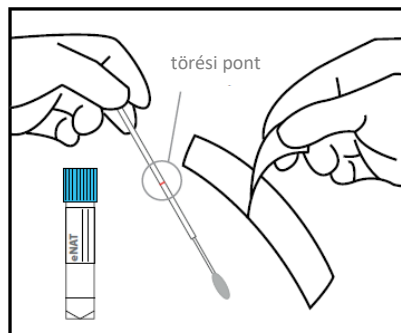


A mintavételi eszközön egy törési pont látható, piros vonallal jelezve.

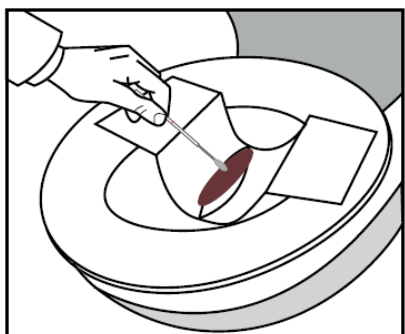

Helyezze a mintavevő eszközt a székletbe, és forgassa az eszközt körülbelül 5 másodpercig.

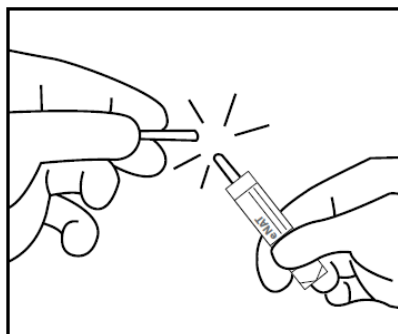

Nyissa ki a puffert tartalmazó csövet. Kerülje a folyadékkal történő érintkezést. Helyezze a pálcát a csőbe, és törje le a törési pontnál.

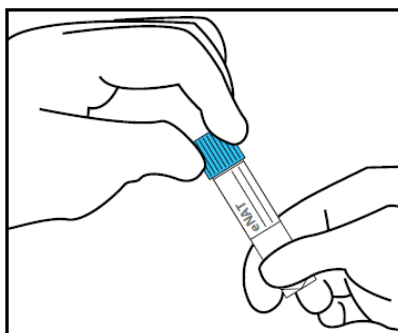

Szorosan zárja le a csövet, és óvatosan rázza körülbelül 10 másodpercig. A csőre írja rá a nevét és születési dátumát. Helyezze vissza a zacskóba és a zacskóra is írja rá a nevét. A mintát szobahőmérsékleten tárolja a leadásig.

